



# CONTIPHARMA

*a member of Bedelco group*

# PROTECT

CATALOGUE 2022



## Kit de Test Antigène SARS-CoV-2

### Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay



Composants	Quantité	Contenu	Poids	Dimension (mm)
Carte de test	25 packs	Carte de test x 25 pcs Déshydratant x 25 pcs	300g	200x115x80
Tube d'extraction	1 pack	Tube d'extraction x 25 pcs		
Bouchon	2 packs	bouchon x 25 pcs		
Ecouvillon	25 packs	Ecouvillon Naso-pharyngé x 25 pcs		
Tampon d'extraction	1 bouteille	Tampon d'extraction x 8ml		
Mode d'emploi	1 copie	1 copie		

## NOM DU PRODUIT

Kit de test de l'antigène du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2(SARS-CoV-2) (test immunologique chromatographique à l'or colloïdal)

## SPÉCIFICATION

Réf. Non.	Montant	Cassette de test	Écouvillon	Tampon d'extraction	Tube d'extraction
SC0232	1 T/Kit	1 pièce	1 pièce	1 x 0,4mL/flacon	1 pièce
SC0233	2 T/Kit	2 pièces	2 pièces	2 x 0,4mL/flacon	2 pièces
SC0234	5 T/Kit	5 pièces	5 pièces	5 x 0,4mL/flacon	5 pièces

## UTILISATION PRÉVUE

Le kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 est un système de test immunochromatographique pour la détection rapide et qualitative de l'antigène du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) dans des échantillons d'écouvillonnage nasal humain. Il peut être utilisé pour le diagnostic de la maladie d'infection à coronavirus (COVID-19) in vitro, qui est causée par le SRAS-CoV-2.

Le kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 fournit des résultats préliminaires. Des résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SRAS-CoV-2. Il ne peut pas être utilisé comme seule base pour un traitement ou toute autre décision de gestion. Le test offre aux personnes la possibilité de réaliser elles-mêmes l'écouvillonnage nasal sous la supervision d'un médecin spécialiste.

## PRINCIPE

Le kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 est basé sur la méthode d'immunochromatographie à l'or colloïdal pour détecter la protéine N du SRAS-CoV-2 dans les sécrétions respiratoires et autres échantillons. Lorsque l'échantillon est ajouté dans le dispositif de test, il est absorbé par l'action capillaire, se mélange avec l'anticorps marqué à l'or et traverse la membrane pré-enduite.

L'antigène SARS-CoV-2 de l'échantillon capturé par l'anticorps S1a marqué à l'or se lie à l'anticorps S1 immobilisé dans la zone de test (T) de la membrane, ce qui produit une bande de test colorée qui indique un résultat positif.

Lorsqu'il n'y a pas d'antigène SARS-CoV-2 dans l'échantillon ou que la concentration est inférieure à la limite de détection du test, il n'y a pas de bande colorée visible dans la zone de test (T) de l'appareil. Cela indique un résultat négatif.

Pour servir de contrôle de procédure, une ligne colorée apparaîtra au niveau de la région de contrôle (C), si le test a été effectué correctement.

## MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

Minuterie

Équipement de protection individuelle, tel que gants de protection, masque médical, lunettes de protection et blouse de laboratoire.

Conteneur pour déchets à risques biologiques et désinfectants appropriés.

#### ÉTAT DE CONSERVATION

La carte de test est stable pendant 12 mois (lorsqu'elle est scellée dans un sac en aluminium) si elle est stockée à 2~30°C. Lorsque l'humidité de l'environnement de test est supérieure à 60 %, la carte de test doit être utilisée immédiatement après l'ouverture du sac en aluminium. Lorsque l'humidité ambiante est inférieure à 60 %, la carte de test doit être utilisée dans l'heure qui suit l'ouverture du sachet en aluminium.

#### COLLECTE ET PRÉPARATION DES SPÉCIMENS

Collecte de spécimens :

1. Il est applicable au diagnostic du Novel coronavirus à partir d'échantillons d'écouvillons nasaux. Utilisez des échantillons fraîchement prélevés pour une performance optimale du test. Un prélèvement inadéquat ou une manipulation incorrecte de l'échantillon peut donner un résultat faux-négatif.
2. Pour le prélèvement d'écouvillons nasaux, insérez l'écouvillon dans une narine du patient. L'extrémité de l'écouvillon doit être insérée à une profondeur de 2 à 4 cm, jusqu'à ce que l'on sente une résistance. Faites ensuite rouler l'écouvillon 5 fois sur la muqueuse à l'intérieur de la narine pour vous assurer que le mucus et les cellules sont recueillis. Répétez cette étape avec le même coton-tige dans l'autre narine afin de recueillir un échantillon suffisant dans les deux narines. Retirez enfin l'écouvillon de la cavité nasale.



#### EXIGENCES RELATIVES AUX SPÉCIMENS

1. Retirer le bouchon d'un tampon d'extraction, ajouter tout le tampon d'extraction dans le tube d'extraction.
2. Placez l'échantillon de l'écouvillon du patient dans le tube d'extraction. Faites rouler la tête de l'écouvillon contre l'intérieur du tube d'extraction au moins 3 fois, puis attendez 1 minute.
3. Retirez l'écouvillon en pressant la tête de l'écouvillon contre l'intérieur du tube pour expulser le plus de liquide possible de l'écouvillon. Jetez l'écouvillon usagé avec vos déchets biologiques.
4. Pressez fermement le capuchon de la buse sur le tube.

Les échantillons extraits peuvent être conservés pendant 1 heure maximum à température ambiante et pendant 4 heures maximum à une température comprise entre 2 et 8 °C.


#### PROCÉDURE DE TEST

1. Sortez la carte de test du sac en aluminium et posez-la à plat sur le banc d'essai.
2. Ajoutez 3 gouttes (environ 80µl) de l'échantillon extrait dans le puits d'échantillon du dispositif de test.
3. Lisez les résultats dans les 15 minutes.

NOTE : L'expérience doit être faite à 15~30.humidité 35%~85%.

### L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

1. La présence de deux lignes (Test et Contrôle), quelle que soit l'intensité de la ligne de test, indique un résultat positif.
2. Une seule ligne de contrôle indique un résultat négatif.
3. Si la ligne de contrôle n'apparaît pas, les résultats ne sont pas valides et le test doit être répété.

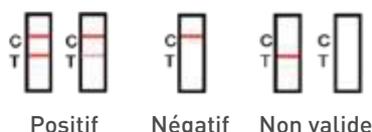

### INSTRUCTIONS POUR L'ACTION EN FONCTION DU RÉSULTAT DU TEST

1. En cas de résultat positif du test :
  - Il y a actuellement une suspicion d'infection par le COVID-19.
  - Contactez immédiatement un médecin/médecin de famille ou les autorités sanitaires locales.
  - Respecter les directives locales en matière d'auto-isolation
  - de faire effectuer un test de confirmation par PCR
2. En cas de résultat négatif du test :
  - Continuez à respecter toutes les règles applicables concernant le contact avec les autres et les mesures de protection.
  - Une infection peut être présente même si le test est négatif.
  - En cas de suspicion, répétez le test après 1 à 2 jours, car le coronavirus ne peut être détecté avec précision dans toutes les phases d'une infection.
3. En cas de résultat de test invalide :
  - Possiblement causé par une mauvaise exécution des tests
  - Répétez le test
  - Si les résultats du test restent invalides, contactez un médecin ou le centre de test COVID 19.

### LIMITATION DE LA MÉTHODOLOGIE

1. Le kit de test de l'antigène du nouveau SRAS-CoV-2 est un test de dépistage en phase aiguë pour une détection qualitative. L'échantillon prélevé peut contenir une concentration d'antigène inférieure au seuil de sensibilité du réactif. Un résultat négatif n'exclut donc pas une infection par le nouveau coronavirus.
2. Le kit de test Novel SARS-CoV-2 Antigen détecte les antigènes viables et non viables du nouveau coronavirus. La performance du test dépend de la charge antigénique de l'échantillon et peut ne pas être corrélée avec la culture cellulaire réalisée sur le même échantillon. Un test positif n'exclut pas la possibilité que d'autres agents pathogènes soient présents. Par conséquent, les résultats doivent être comparés à toutes les autres informations cliniques et de laboratoire disponibles pour établir un diagnostic précis.
3. Un résultat négatif peut être obtenu si le niveau d'antigène extrait dans un échantillon est inférieur à la sensibilité du test ou si un échantillon de mauvaise qualité est obtenu.
4. La performance du test n'a pas été établie pour le suivi du traitement antiviral du nouveau coronavirus.

5. Un test positif n'exclut pas la possibilité de co-infections avec d'autres agents pathogènes.
6. Un résultat négatif ne permet pas d'exclure une autre infection à coronavirus que le SARS-CoV-2.
7. Les enfants ont tendance à excréter le virus pendant de plus longues périodes que les adultes, ce qui peut entraîner des différences de sensibilité entre les adultes et les enfants List.
8. Un résultat négatif peut survenir si la concentration d'antigène dans un échantillon est inférieure à la limite de détection du test ou si l'échantillon a été collecté ou transporté de manière incorrecte. Par conséquent, un résultat négatif n'élimine pas la possibilité d'une infection par le SRAS-CoV-2 et doit être confirmé par une culture virale ou une PCR.

#### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

##### 1. SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ

Les échantillons d'écouvillons nasaux de 226 patients, dont 107 résultats positifs et 119 résultats négatifs ont été confirmés par le jugement du diagnostic clinique. Le résultat de l'évaluation clinique du kit de test de l'antigène du SRAS-CoV-2 était le suivant :

Méthode		PCR		SOMME
SRAS-CoV-2 Kit de test antigénique	Résultat	Positif	Négatif	
	Positif	102	1	103
	Négatif	5	118	123
SOMME		107	119	226
Sensibilité		95,33% [95%CI:91,31%~96,20%]		
Spécificité		99,16% [95%CI:95,39%~99,85%]		
Précision		97,35% [95%CI:95,37%~97,74%]		

##### 2. LIMITE DE DÉTECTION (LoD)

2019-nCoV Concentration	1 X 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> /mL					
Dilution	1/100	1/200	1/400	1/800	1/1600	1/3200
Concentration dans la dilution testée (TCID <sub>50</sub> /ml)	1X10 <sup>4</sup>	5X10 <sup>3</sup>	2.5X 10 <sup>3</sup>	1.25X10 <sup>3</sup>	6.25X10 <sup>2</sup>	3.125X10 <sup>2</sup>
Taux de 20 répétitions (%)	100(20/20)	100(20/20)	100(20/20)	100(20/20)	100(20/20)	10(2/20)
Limite de détection	6.25X10 <sup>2</sup> TCID <sub>50</sub> /mL					

### 3. EXPÉRIENCE D'INTERFÉRENCE

Les substances suivantes ont été testées à la concentration indiquée, et aucune interférence n'a été trouvée.

Mucine	100µg/mL	Acide acétylsalicylique	3,0 mM
Sang total	5% (v/v)	Ibuprofène	2,5 mM
Biotine	100µg/mL	Mupirocine	10 mg/mL
Néo-Synéphrine (Phényléphrine)	5%(v/v)	Tobramycine	10µg/mL
Afrin Spray nasal (Oxymétazoline)	5%(v/v)	Erythromycine	50uM
Spray nasal salin	5%(v/v)	Ciprofloxacine	50uM
Homéopathie	5%(v/v)	Ceftriaxone	110mg/mL
Cromoglycate de sodium	10 mg/mL	Meropenem	3,7µg/mL
Chlorhydrate d'olopatadine	10 mg/mL	Tobramycine	100µg/mL
Zanamivir	5 mg/mL	Histamine	100µg/mL
Oseltamivir	Chlorhydrate	100µg/mL	1mmol/mL
Artéméther-luméfantine	10 mg/mL	Peramivir	100µg/mL
Doxycycline hyclate	50uM	Flunisolide	0,64nmol/ L
Quinine	50uM	Budesonide	0,3ng/mL
Lamivudine	150uM	Fluticasone	6µg/mL
Ribavirine	1 mg/mL	Lopinavir	8,2mg/mL
Daclatasvir	1 mg/mL	Ritonavir	417.8ng/mL
Acétaminophène	1 mg/mL	Abidor	N/A

### 4. RÉACTIVITÉ CROISÉE

Virus/Bactérie/ Parasite	Souche	Source/type de spécimen	Concentration	Résultat
SRAS-coronavirus	N/A	SINO/protéine recombinante	25ug/mL	Négatif
MERS-coronavirus	N/A		72 ug/mL	Négatif
Adénovirus	Type 1	AMMS Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 3		7,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 5		4,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 7		1,0E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 8		1,0E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 11		2,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 18		2,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 23		6,0E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 55		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
Influenza A	H1N1 Denver	AMMS / Virus de culture inactivé	3,0E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	H1N1 WS/33		2,0E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	H1N1 A/Ma/302/54		1,5E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	H1N1 Nouvelle-Calédonie		7,6E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	H3N2 A/ Hong Kong/8/68		4,6E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif

Virus/Bactérie/ Parasite	Souche	Source/type de spécimen	Concentration	Résultat
Influenza B	Nevada/03/2011	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	B/Lee/40		8,5E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	B/Taiwan/2/62		4,0E+08TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
Virus respiratoire syncytial	N/A	AMMS / Virus de culture inactivé	2,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
Legionella pneumophila	Bloomington-2	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	Los Angeles-1		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	82A3105		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
Mycobacterium tuberculosis	K	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	Erdman		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	HN878		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	CDC1551		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	H37Rv		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
Streptococcus pneumonia	4752-98 [Maryland (D1)6B-17]	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	178 [Pologne 23F-16]		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	262 [CIP 104340]		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	Slovaquie 14-10 [29055]		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
Streptococcus pyrogènes	Souche de typage T1 [NCIB 11841, SF 130]	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
Mycoplasma pneumoniae	Mutant 22	AMMS / Virus de culture inactivé	1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	Souche FH de l'agent E aton [NCTC10119]		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
	36M129-B7		1×10 <sup>5</sup> PFU/mL	Négatif
Coronavirus	229E	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	OC43		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	NL63		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	HKU1		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
Etapneumovirus humain (hMPV) 3 Type B1	Pérou2-2002	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
Métapneumovirus humain	IA10-2003	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
(hMPV) 16 Type A1	Type 1	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 2		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 3		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
	Type 4A		1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif
RhinoVIRUS A16	N/A	AMMS / Virus de culture inactivé	1,5E+06TCID <sub>50</sub> /mL	Négatif

## ATTENTION

1. Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.
2. Une collecte, un stockage et un transport appropriés des échantillons sont essentiels à la réalisation de ce test.
3. A n'utiliser qu'une seule fois.
4. Ne pas toucher la zone de réaction de la bande de test.
5. N'utilisez pas le kit de test au-delà de la date d'expiration.
6. N'utilisez pas le kit si la pochette est percée ou mal fermée.
7. Après utilisation, jetez les cartes de test et les articles en contact avec les échantillons comme des déchets médicaux.
8. Ne pas congeler.

## INTERPRÉTATION DES ICÔNES



Ne pas réutiliser



Dispositif médical de diagnostic in vitro



Contient des éléments suffisants pour <n>test



Fabricant



Marque CE



Garder au sec



Fragile, à manipuler avec précaution



Limite de température



Code du lot



Consultez le mode d'emploi



Date de fabrication




Date limite d'utilisation



Par ici, en haut



Limite des couches d'empilage



Représentant autorisé dans la Communauté européenne

## INFORMATIONS GÉNÉRALES



Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec. Co., Ltd.  
Room 701, No.71-3, Xintian Avenue, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, P. R. China 518103  
Tél : +86-755-82599902  
Fax : +86-755-82599221



CMC Dispositifs médicaux et médicaments S.L.  
C/ Horacio Lengo N°18, CP 29006, Málaga, Espagne  
Tél : +34951214054  
Mail: info@cmcmedicaldevices.com

Date d'émission : 24/03/2021

## Kit de test de l'antigène SARS-CoV-2



### NOM DU PRODUIT

NEWGENE - Kit de Détection de l'Antigène COVID-19.

### SPECIFICATION

Méthode à échantillons multiples : Prélèvement nasal / Prélèvement nasopharyngé / Prélèvement oropharyngé / Prélèvement salivaire

Divers emballages disponibles : 25 Tests/Boîte, 5 Tests/Boîte or 1 Test/Boîte

Reconnaissance mondiale : Enregistré dans plus de 20 pays, exporté dans plus de 50 pays

Détection rapide : Résultat en 15 minutes

Rendement supérieur : sensibilité et spécificité élevées


Le kit de détection rapide du COVID-19 NEWGENE COVID-19 est actuellement enregistré dans de nombreux pays, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique, le Portugal, la Tchéquie, le Danemark, la Hongrie, la Grèce, la Pologne, la Moldavie, le Pérou, l'Argentine, l'Equateur, le Kenya, le Zimbabwe etc., et a passé la validation clinique dans les laboratoires nationaux d'Allemagne, de Suisse, d'Equateur, du Zimbabwe etc. Ce produit affiche de bonnes performances de sensibilité et de spécificité comparativement aux produits de marque internationale et est exporté dans plus de 50 pays et régions.

## INTRODUCTION


### 1. PRÉLÈVEMENT NASAL

Composants	Boîte de 25 tests	Boîte de 5 tests	Boîte de 1 test
Carte de test	25	5	1
Tube d'extraction et bouchon	25	5	1
Ecouvillon pour prélèvement nasal	25	5	1
Notice d'utilisation	1	1	1

#### PROCÉDURES DE TEST: ÉCHANTILLON

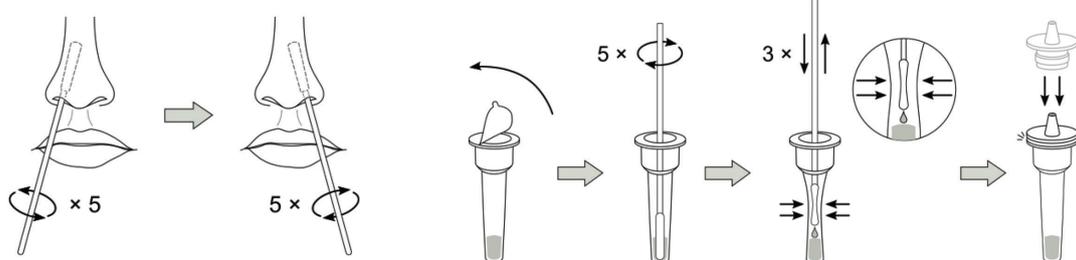

#### PROCÉDURES DE TEST: DÉTECTION

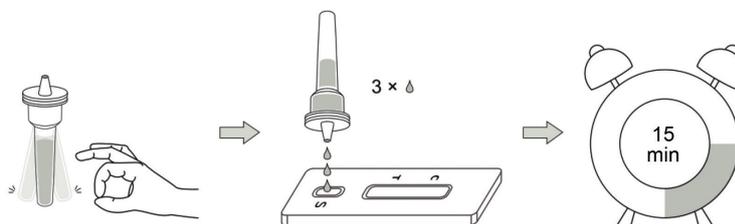

#### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

COVID-19 Ag

C

T

S

➔

**Positif(+):**  
Des bandes rouges apparaissent en face des repères C et T dans les 15 à 30 minutes. Une bande blanche en face de la ligne T peut être considérée comme un résultat négatif.

**Négatif(-):**  
Une bande rouge apparaît en face du repère C et aucune bande rouge n'apparaît en face du repère T endéans les 15 à 30 minutes après le dépôt de l'échantillon

**Invalide:**  
Si aucune bande rouge n'apparaît en face du repère C, cela indique que le test est invalide, et qu'il doit être refait avec une nouvelle carte.


#### PERFORMANCE

Sensibilité	97.1%
Spécificité	99.2%


## 2. PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ

Composants	Boite de 25 tests	Boite de 5 tests	Boite de 1 test
Carte de test	25	5	1
Tube d'extraction et bouchon	25	5	1
Ecouvillon pour prélèvement nasal	25	5	1
Notice d'utilisation	1	1	1

### PROCÉDURES DE TEST: ÉCHANTILLON

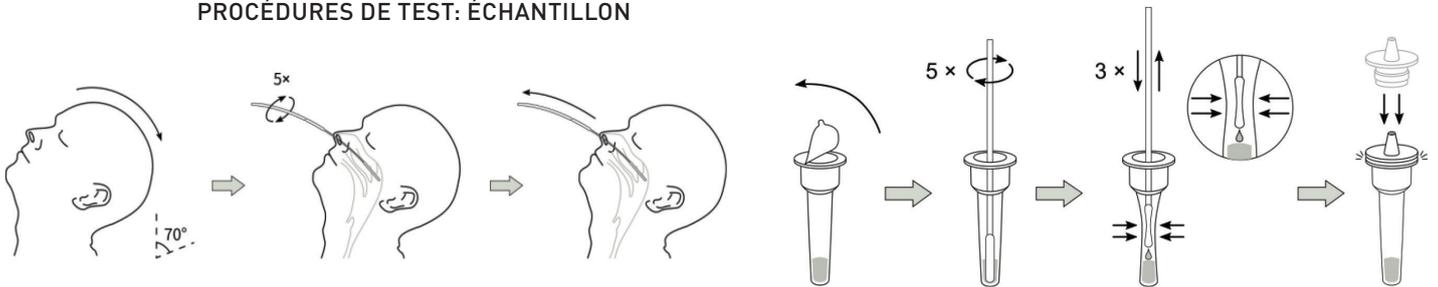

### PROCÉDURES DE TEST: DÉTECTION

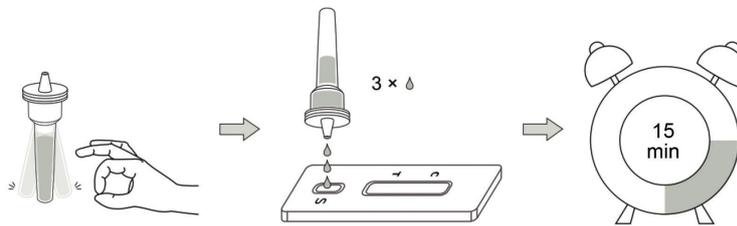

### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

COVID-19 Ag

C

T

S

➔

**Positif(+):**  
Des bandes rouges apparaissent en face des repères C et T dans les 15 à 30 minutes. Une bande blanche en face de la ligne T peut être considérée comme un résultat négatif.

**Négatif(-):**  
Une bande rouge apparaît en face du repère C et aucune bande rouge n'apparaît en face du repère T endéans les 15 à 30 minutes après le dépôt de l'échantillon

**Invalide:**  
Si aucune bande rouge n'apparaît en face du repère C, cela indique que le test est invalide, et qu'il doit être refait avec une nouvelle carte.


### PERFORMANCE

Sensibilité	98,0%
Spécificité	99,1%


### 3. PRÉLÈVEMENT OROPHARYNGÉ

Composants	Boite de 25 tests	Boite de 5 tests	Boite de 1 test
Carte de test	25	5	1
Tube d'extraction et bouchon	25	5	1
Ecouvillon pour prélèvement nasal	25	5	1
Notice d'utilisation	1	1	1

#### PROCÉDURES DE TEST: ÉCHANTILLON

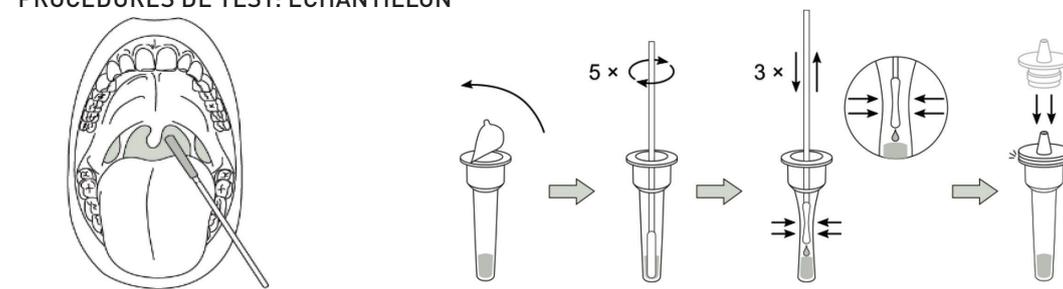

#### PROCÉDURES DE TEST: DÉTECTION

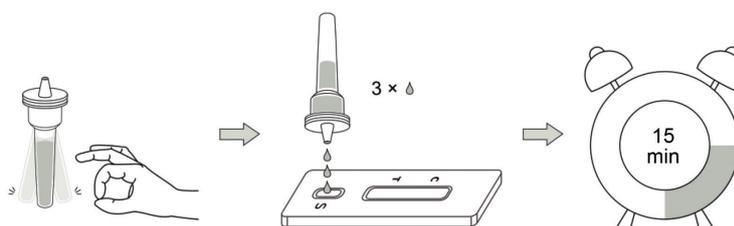

#### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

COVID-19  
Ag

C

T

S

➔

**Positif(+):**  
Des bandes rouges apparaissent en face des repères C et T dans les 15 à 30 minutes. Une bande blanche en face de la ligne T peut être considérée comme un résultat négatif.

**Négatif(-):**  
Une bande rouge apparaît en face du repère C et aucune bande rouge n'apparaît en face du repère T endéans les 15 à 30 minutes après le dépôt de l'échantillon

**Invalide:**  
Si aucune bande rouge n'apparaît en face du repère C, cela indique que le test est invalide, et qu'il doit être refait avec une nouvelle carte.


#### PERFORMANCE

Sensitivity	95,7%
Specificity	99,0%


## 4. PRÉLÈVEMENT SALIVAIRE

Composants	Boite de 25 tests	Boite de 1 test
Carte de test	25	1
Tube d'extraction et bouchon	25	1
Gobelet en papier	25	1
Pipette à salive	25	1
Notice d'utilisation	1	1

### PROCÉDURES DE TEST: ÉCHANTILLON

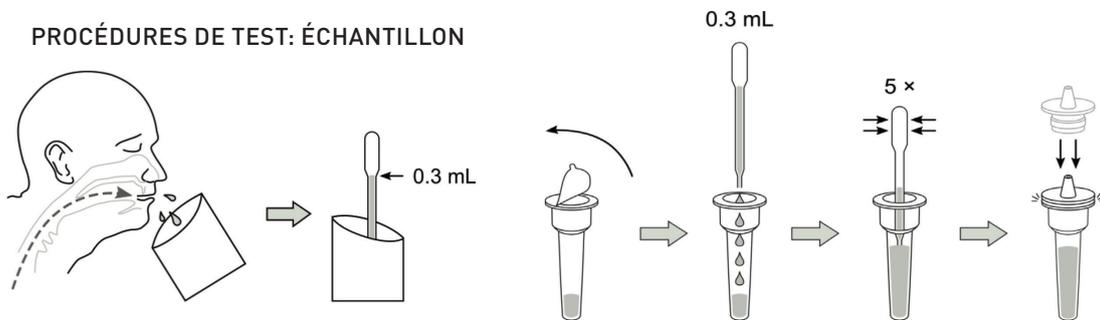

### TEST PROCÉDURES: DÉTECTION

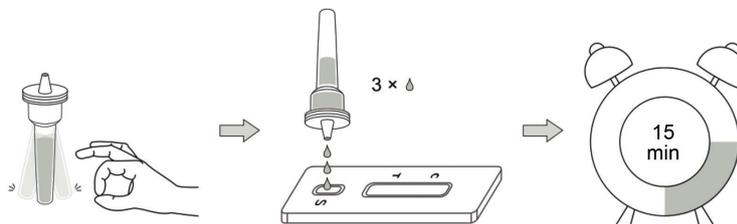

### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

COVID-19 Ag

C

T

S

➔

**Positif(+):**  
Des bandes rouges apparaissent en face des repères C et T dans les 15 à 30 minutes. Une bande blanche en face de la ligne T peut être considérée comme un résultat négatif.

**Négatif(-):**  
Une bande rouge apparaît en face du repère C et aucune bande rouge n'apparaît en face du repère T endéans les 15 à 30 minutes après le dépôt de l'échantillon

**Invalide:**  
Si aucune bande rouge n'apparaît en face du repère C, cela indique que le test est invalide, et qu'il doit être refait avec une nouvelle carte.

### PERFORMANCE

Sensibilité	97,3%
Spécificité	99.2%

## INFORMATION D'EMBALLAGE

Prélèvement Nasopharyngé: NPS  
 Prélèvement nasal: NS  
 Prélèvement Oropharyngé: OS  
 Prélèvement Oropharyngé: S

## BOÎTE

25 TESTS/BOITE

Echantillon	NPS	NPS+S	NS	NS+S	OS	OS+S	S
Boîte (mm)	230*140*80						230*120*67
Poids d'une boîte (kg)	0.34	0.38	0.32	0.36	0.35	0.4	0.39
Carton (mm)	585*485*425						510*490*360
Poids d'un carton (kg)	1.5						1.3
PCS/Boite	25						
Boîte/Carton	40						
PCS/Carton	1000						
Volume/Carton	0.12CBM						0.09CBM
Poids Net/Carton (kg)	13.6	15.2	12.8	14.4	14	16	15.6
Poids Brut/Carton (kg)	15.1	16.7	14.3	15.9	15.5	17.5	16.9



**NEWGENE**  
 C/COV-19 Antigen Detection Kit  
 (Rapid Test)  
 CE (MD)  
 IVD  
 Low-COVID-19 antigen  
 (Rapid Test)  
 For qualitative detection of SARS-CoV-2  
 (Rapid Test)  
 NEWGENE  
 Bioengineering

**INDICATIONS**  
 For qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen in nasal and oropharyngeal swabs.

**CONTRAINDICATIONS**  
 This product is not intended for use in patients with known or suspected COVID-19 infection.

**WARNINGS**  
 This product is not intended for use in patients with known or suspected COVID-19 infection.

**PRECAUTIONS**  
 This product is not intended for use in patients with known or suspected COVID-19 infection.

**STORAGE AND SHIPMENT**  
 Store at 2-8°C (32-37°F) and avoid exposure to light.

**LOT NUMBER**  
 NEWGENE-2020-001

**DATE OF MANUFACTURE**  
 2020-03-15

**EXPIRY DATE**  
 2020-09-15

**REVISION**  
 1.0



## 5 TESTS/BOÎTE

Echantillon	Taille (mm)	NS	Poids (kg)
Boîte intérieure (mm)	193*85*42		0.081
Boîte extérieure (mm)	225*197*89		0.5
Carton	470*410*470		1.3
PCS/Boîte intérieure		5	
Boîte intérieure/Boîte extérieure		5	
PCS/Carton		500	
Volume/Carton		0.09CBM	
Poids Net/Carton (kg)		10	
Poids Brut/Carton (kg)		11.3	



## 1 TEST/BOÎTE

Echantillon	S	NS	NS+S	NPS	OS	NPS+S	OS+S
Boîte intérieure (mm)		143*83*15				170*66*15	
Poids de la boîte intérieure (kg)	0.026	0.027	0.03	0.024	0.028	0.028	0.032
Boîte extérieure (mm)		305*197*88				277*182*112	
Poids de la boîte extérieure (kg)	0.78	0.80	0.88	0.73	0.83	0.83	0.93
Carton (mm)		630*420*470				590*570*395	
Poids du carton (kg)		1.8				2.2	
PCS/boîte intérieure				1			
Boîtes intérieures/boîte extérieure				25			
PCS/Carton				500			
Volume/Carton		0.13CBM				0.133CBM	
Poids Net/Carton (kg)	15.6	16	17.6	14.6	16.6	16.6	18.6
Poids Brut/Carton (kg)	17.4	17.8	19.4	16.8	18.8	18.8	20.4



## INTERPRÉTATION DES ICONES



Ne pas réutiliser



Dispositif médical  
de diagnostic in vitro



Contient des éléments  
suffisant pour <n> tests



Fabricant



Marquage CE



Garder au sec



Tenez à l'écart de la  
lumière du soleil



Stockez entre 2-30°C



Numéro de lot



Consultez le  
mode d'emploi



Date de fabrication




Date d'expiration



Haut



Ne pas utiliser si l'emballage  
est endommagé



Representant Officiel en Communauté Européenne

## INFORMATION GÉNÉRALE



Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec. Co., Ltd.  
Room 701, No.71-3, Xintian Avenue, Xintian Community, Fuhai  
Street, Baoan District, Shenzhen, P.R.China 518103  
Tel: +86-755-82599902  
Fax: +86-755-82599221




CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/ Horacio Lengo N°18, CP 29006, Málaga, Spain  
Tel: +34951214054  
Mail: info@cmcmedicaldevices.com



Serrage élastique souple, sans pression  
Très léger, agréable à porter  
Zéro entretien (usage unique)

**SPÉCIFICATIONS**

- Modèle rond avec **double élastique**
- Couleur : bleue/blanche
- Usage unique
- En polypropylène non tissé
- Poids : 12 g/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sachet de 100 pièces

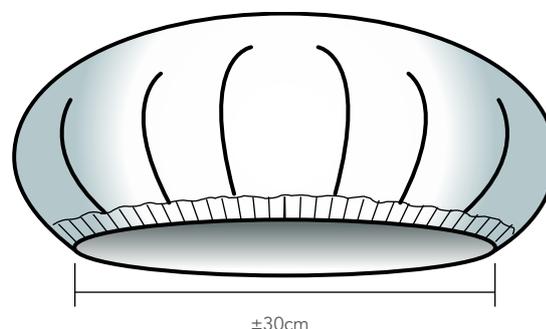



#### APPLICATION

Utilisation : Ces charlottes peuvent être utilisées lors de nombreux travaux nécessitant de vous protéger contre de légères salissures et/ou de protéger l'environnement contre les particules et micro-poussières émises par l'utilisateur. Industrie pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, d'entretien, hôpitaux, entretien ménager, industries agroalimentaire, fromageries, laiteries, visites d'usines, conditionnement et emballage...

Article de propreté : Ce produit n'est pas un équipement de protection individuel mais un article de propreté; ne pas utiliser contre des dangers susceptibles de menacer la santé ou la sécurité de l'utilisateur. Lors des activités dans certains milieux sensibles comme l'alimentaire, l'électronique, il est généralement obligatoire de retirer tout objet personnel décoratif : bagues, colliers, bracelets...

## Cagoule avec masque intégré

Ref 10002



### SPÉCIFICATIONS

Cagoule polypropylène avec masque type II intégré

La cagoule en polypropylène 25 g intègre un masque 3 couches avec une bonne capacité de filtration (type II). Sa perméabilité à l'air assure un grand confort.

Elle est particulièrement adaptée pour les entreprises alimentaires et les abattoirs où un masque médical est obligatoire. Une barrette nasale malléable assure une adaptation individuelle au visage et les élastiques sans latex permettent également aux personnes allergiques d'utiliser le produit.

## Combinaison CoverTex® C-1



### SPÉCIFICATIONS

**Description :** · capuche élastique en 3 parties pour un ajustement optimal - poignets, chevilles et taille élastiques.  
· Fermeture à glissière à double sens.  
· couverture zippée/rabat d'estomac.  
· finition antistatique.

**Matériau :** multicouche (SMMS) PP spunbond

**Catégorie PSA :** Cat. III - Type 5 + 6.

EN ISO 13688:2013.



EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010.



EN 1073-2:2002.



EN 1149-5:2008.

EN 14325:2004.



EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6.

**Institut de certification :** Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A (Centrocot), Piazza S. Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA) - Italie, numéro d'organisme notifié 0624.

**Numéro de certificat :** CE 0672180430-00-00

**Tailles :** S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL



**CONTIPHARMA**

*a member of Bedelco group*

**PROTECT**

**Couleur :** blanc

**Unité d'emballage :** 50

**Pays d'origine :** CN / VR China

**Code des douanes :** 62101098000



**CONTIPHARMA**  
a member of Bedelco group  
**PROTECT**

**Surblouse 35g**

Ref 30001



#### SPÉCIFICATIONS

- Blouse polypropylène Bleue/Blanche/Verte jetable, pour tout type d'usage et une protection efficace
- 35g/m<sup>2</sup>
- Fermeture à cordon – attache derrière
- Perméable à l'air
- Peu absorbant
- Convient pour les milieux médicaux, agroalimentaires, restauration collative, industries
- Taille unique
- Tour de poitrine : 690 mm x 2
- Longueur de la manche depuis le col : 780 mm
- Largeur de la manche : 250 mm
- Longueur totale : 1050 mm
- Conditionnement : carton de 100 pcs





#### SPÉCIFICATIONS

- Blouse jetable en polypropylène pour tout type d'usage et protection efficace
- 35 g/m<sup>2</sup>
- col cousu
- fermeture velcro – à l'avant
- avec poches
- perméable à l'air
- peu absorbant
- Convient pour les milieux médicaux, agroalimentaires, restauration collective, industrie
- taille unique
- tour de poitrine : 690 mm x 2
- Longueur de la manche depuis le col : 780 mm
- Largeur de la manche : 250 mm
- Longueur totale : 1050 mm
- Conditionnement : carton de 100 pcs





#### SPÉCIFICATIONS

- Couleur : blanche / bleue
- Polypropylène 25 gr
- Resserrée par élastique aux poignets
- Attache derrière par cordon
- Taille unique





#### SPÉCIFICATIONS

- Tablier avec attache devant par velcro
- Couleur : blanche
- Polypropylène 25 g
- Avec col
- Poignets resserrés par élastique
- Taille : M / L / XL





Combinaison en polypropylène/polyéthylène blanche avec des bandes bleues, 65 gr, jetable, avec capuche et élastique à la taille aux poignets et aux chevilles.

Taille : L - XL - XXL

Ces combinaisons offrent une solution de vêtement efficace et peu coûteux qui protège contre les particules sèches comme la saleté et la poussière sur le lieu de travail. Ils sont légers, confortables, la peau peut respirer et ils peuvent être utilisés dans des milieux tels que les hôpitaux, les usines de transformation des aliments et les applications industrielles générales.

Facile à endosser, antipoussière, antibactérien, antiviral

Certificats : sur demande





### SPÉCIFICATIONS

- Surchaussure antidérapante en propylène non tissé, non stérile
- Élastique de serrage aux chevilles pour un maintien parfait
- Semelle gaufrée antidérapante, renforcée et imperméable
- Couleur : blanc avec semelle bleue
- Dimensions : 16,5 x 41,5 cm
- Grammage : 30g/m<sup>2</sup>

Nos surchaussures assurent une barrière efficace contre les bactéries et les virus.  
Le port de ces protections réduit aussi les risques d'accident au travail.

Leurs avantages :

- Garantir la propreté des locaux pour une hygiène optimale ;
- Éviter les contaminations extérieures ;
- Protéger les chaussures des éclaboussures ou des projections salissantes ;
- Réduire les risques d'accident au travail ;
- Protéger les salariés et les visiteurs de passage.



#### APPLICATION

- Industries agroalimentaires
- Secteur de la microélectronique
- Filières automobiles
- Industrie spatiale
- Hôpitaux et établissements de santé

## Gants GOLD TOUCH



### SPÉCIFICATIONS

- Marquage du gant : identification du fabricant ou de son représentant, référence du produit, marque CE et taille, EN-standard.

### CARACTÉRISTIQUES

- Gant en nylon rouge et spandex enduit de nitrile noir.

### CONFORMITÉ

- CE cat.2 : GANTS au design moyen : risques intermédiaires.
- Tous les examens de type CE ont été réalisés par CTC notified body nr (0075) Cert. nr 0075/032/162/01/19/0079.

### NIVEAUX DE PERFORMANCES

Risques mécaniques testés d'après l'EN 388:2016

- Abrasion : 4
- Coupure : 1
- Déchirure : 3
- Perforation : 1
- Coupure EN ISO 13997 : X

#### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Il est préférable de nettoyer les gants à sec à l'aide d'une brosse. L'utilisation de liquides de nettoyage ou de produits chimiques peut altérer les propriétés des gants, ce pour quoi le fabricant ne peut être tenu responsable.

---

#### **CONSERVATION ET STOCKAGE**

Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets. Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant au moins 2 ans. Il est impossible de prévoir leur durée de vie car elle dépend de l'utilisation qui en est faite. L'utilisateur doit toujours vérifier que les gants conviennent à l'utilisation qui en est faite.

## Gants de maîtrise Guyard 1532 NAT LR



### SPÉCIFICATIONS

- Gant type maîtrise en cuir de bovin
- Risques intermédiaires – Cat. II

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuir pleine fleur de bovin naturel.
- Elastique de serrage sur le dos.
- Coupe américaine.
- Tannage chrome.
- Longueur : 22 à 28 cm selon la taille, (+0,5 /-0,5 mm).
- Tailles disponibles : 8 à 11.

### CONFORMITÉ

- Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n° 0162 EN 420 / 2003 + A1 / 09 - EN 388 / 2016 – EN ISO 13997
- Déclaration UE 2016/425 disponible sur demande

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne maintenance.
- Travaux en milieu sec.

#### NIVEAUX DE PERFORMANCES

- Abrasion : 3 / 4
  - Coupure EN 388 / 2016 : 1 / 5
  - Déchirure : 2 / 4
  - Perforation : 2 / 4
  - Coupure EN ISO 13997 : A / F
- 

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
  - Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- 

#### LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > à 50°C.
  - Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.
- 

#### INNOCUITÉ, CONFORT & DEXTÉRITÉ

- Dextérité, niveau 5.
  - Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.
- 

#### CONDITIONNEMENT

- Sachet : 10 paires.
  - Cartons : 100 paires.
- 

#### ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

## Gants de maîtrise Guyard 1545 150 PA CH



### SPÉCIFICATIONS

- Gant type maîtrise en cuir de caprin naturel.
- Risques intermédiaires – Cat. II.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cuir pleine fleur de caprin naturel.
- Manchette cuir croûte naturel de 150 MM.
- Protection de l'artère.
- Tannage chrome.
- Longueurs : 35 à 39 cm selon la taille.
- Tailles disponibles : 8 à 11.

### CONFORMITÉ

- Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162 - EN 420/2003 + A1/2009 - EN 388/2016 - EN 407 : 2004 - ISO 13997 - EN 12477 : 01/A1 : 05 TYPE B.
- Déclaration UE 2016/425 disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr).

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Gants conçus pour les travaux de soudagen.

## NIVEAUX DE PERFORMANCES

- Abrasion : 2 / 4
- Coupure : 1 / 5 & A/F
- Déchirure : 2 / 5
- Perforation : 1 / 5
- Comportement au feu : 4 / 4
- Chaleur de contact : 1 / 4
- Chaleur convective : 1 / 4
- Chaleur radiante : 2 / 4
- Petites projections de métal liquide : 4 / 4
- Grosses projections de métal liquide : X / 4

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

## LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

## INNOCUITÉ, CONFORT & DEXTÉRITÉ

- Dextérité, niveau 5.
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

## CONDITIONNEMENT

- Sachet : 10 paires.
- Cartons : 100 paires.

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

## Gant Soudeur Guyard 1567 350 DM PH



### SPÉCIFICATIONS

- Gant Soudeur en croûte de bovin.
- Risques intermédiaires – Cat. II.

### CARACTÉRISTIQUES

- Gants en croûte de bovin.
- Coloris rouge.
- Entièrement doublés de molleton.
- Cousus fil 100% polyamide aromatique.
- Renfort croûte, paume et pouce, coloris brun.
- Tailles disponibles : 9 à 10.

### CONFORMITÉ

- Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162 - EN 420/03 +A1/09 - 407/04 - EN 388/16 – ISO 13997 - EN 12477/2001 TYPE A.
- Déclaration UE 2016/425 disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr).

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Gants soudure MIG, MAG & ARC.

## NIVEAUX DE PERFORMANCES

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure EN 388 / 2016 : 1 / 5
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 4 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : B / F
- Comportement au feu : 4 / 4
- Chaleur de contact : 1 / 4
- Chaleur convective : 3 / 4
- Chaleur radiante : 3 / 4
- Petites projections de métal liquide : 4 / 4
- Grosses projections de métal liquide : X

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

## LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

## INNOCUITÉ, CONFORT & DEXTÉRITÉ

- Dextérité, niveau 1.
- Ces gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

## CONDITIONNEMENT

- Sachet : 12 paires.
- Cartons : 60 paires.

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

## Gant Tricot HPPE Guyard MECASAFE 6550 30



### SPÉCIFICATIONS

- Gant tricot HPPE / fibre de verre, enduction polyuréthane.
- Risques intermédiaires – Cat. II.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tricot polyéthylène haute densité 50.0%, fibre de verre 25.0%, polyester 22.0%, spandex 3.0%.
- Enduction polyuréthane de coloris gris dans la paume.
- Dos aéré.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.

### CONFORMITÉ

- Déclaration délivrée par le CTC (France) n 00075 EN 420 1 03 + AI / 09 - EN 388 12016 - EN ISO 13997.
- Déclaration UE 2016/425 sur demande.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou légèrement grasses, verre.
- Industrie, BTP.

## NIVEAUX DE PERFORMANCES

- Abrasion : 4 / 4
  - Coupure EN 388 / 2016 : 4 / 5
  - Déchirure : 4 / 4
  - Perforation : 3 / 4
  - Coupure EN ISO 13997 : D / F
- 

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
  - Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- 

## LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
  - Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.
- 

## INNOCUITÉ, CONFORT & DEXTÉRITÉ

- Dextérité, niveau 5.
  - Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.
- 

## CONDITIONNEMENT

- Sachet : 10 paires.
  - Cartons : 200 paires.
- 

## ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.



### SPÉCIFICATIONS

Les gants d'examen « Purism » G001 conviennent aux environnements de travail où il y a contact possible avec des fluides corporels, des micro-organismes et des produits chimiques. Ils ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel et constituent une excellente alternative pour les personnes souffrant d'allergies de type I.

Ce sont des gants non poudrés qui offrent une grande souplesse, un toucher de grande sensibilité et une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont résistants aux déchirures, ambidextres et non stériles.

### TAILLES

Taille	Longueur minimale (mm)	Largeur de paume (mm)	Poids (g)	Épaisseur minimum (mm)
XS	240	≤80	3.8 ± 0.2	0,05
S	240	80 ± 10	4.3 ± 0.2	0,05
M	240	95 ± 10	4.8 ± 0.2	0,05
L	240	110 ± 10	5.3 ± 0.2	0,05
XL	240	≥110	5.8 ± 0.2	0,05

### NORME

EN455



#### PRINCIPALES MATIERES PREMIERES

- Caoutchouc nitrile butadiène ≥90%
- Oxyde de zinc 4%
- Dioxyde de titane 2,6%

#### UTILISATION

Domaine médical, industries alimentaires, industries chimiques,...

#### REMARQUES

- Les gants d'examen sont des produits à usage unique et ne doivent être utilisés que pour une seule procédure et/ou un seul patient
- Lorsque vous portez des gants, ne portez pas de bagues ou autres ornements et coupez les ongles en douceur
- Portez-les indifféremment sur la main gauche ou droite, veuillez choisir des gants adaptés aux spécifications de votre main
- Ne pas utiliser si les gants sont contaminés en raison d'un emballage défectueux
- Ne pas irradier directement une lumière forte telle que la lumière du soleil ou les rayons ultraviolets

#### CONDITIONNEMENT

carton de 100 pcs

#### STOCKAGE

Les gants doivent être stockés dans un environnement frais, sec et sombre sans gaz corrosifs.

## Masques FFP2 / KN95



EXTERIEUR



INTERIEUR

MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 95%



## SPÉCIFICATIONS

Masque 5 couches :

- Première couche : 60g/m<sup>2</sup> en tissu non tissé
- Seconde et troisième couche : 30g/m<sup>2</sup> en tissu non tissé haute efficacité, soufflé par fusion
- Quatrième couche : 50g/m<sup>2</sup> coton à air chaud
- Cinquième couche : 25g/m<sup>2</sup> en tissu non tissé

Composition :

Non-tissés liés par filage, non-tissés soufflés par fusion, coton à air chaud, pince-nez, boucles d'oreille

Performance du produit :

Ajustement parfait pour chaque visage et protection optimale. Convient pour la protection de certaines particules non huileuses, telles que le virus de la grippe, la poussière, le pollen, etc.

Temps de port recommandé :

4-8 heures, à changer entre deux actes médicaux. Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.

---

## APPLICATION

Écoles, trains à grande vitesse, aéroports, transports publics et autres lieux relativement densément peuplés et environnement familial.

---

## CONFORMITÉ

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE

Norme 149:2001 + A1:2009 / GB2626-2006 KN95 en lien avec le règlement CE R2016/425 (Personal Protective Equipment)



## CONDITIONNEMENT

5 pcs / paquet, 4 paquets / boîte., 48 btes / carton, 960 pièces / carton,  
 Dimensions du carton : 57,5 × 33,5 × 38 cm – 8,35 kg

## STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et propre, à l'écart du feu, entre -20 et 38 ° C avec une humidité relative inférieure à 30%.

## DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans

## Masques respiratoire FFP3 Purism



### MARQUE

PURISM

---

### EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 95% (testé selon les normes GB2626-2019)

---

### TAILLE

13,8x11x5x5,2 cm

---

### SPÉCIFICATIONS

Masque 5 couches :

- tissu non tissé en PP
- tissu soufflé par fusion en PP
- tissu non tissé par air
- pince-nez en aluminium
- serre tête en nylon/polyuréthane composite



#### APPLICATION

Les respirateurs à particules Purism FFP3 offrent une protection respiratoire efficace pour une utilisation dans les industries où les travailleurs seront exposés à des particules solides (poussières) et / ou des particules liquides non volatiles. Idéal pour les applications où un facteur de protection plus élevé est requis, offrant une protection contre la plupart des gaz, vapeurs et particules.

---

#### CONFORMITÉ

Marquage CE 2016/425  
Norme EN 149/2001+a1/2009

---

#### CONDITIONNEMENT

20 pces / boîte., 20 boîtes / carton, 400 pièces / carton,  
Dimensions du carton : 67 × 28 × 36 cm – 11,7 kg

---

#### STOCKAGE

à stocker dans un endroit gazeux sec, propre, ventilé et non corrosif, loin de sources d'ignition ou de matériaux combustibles

---

#### DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans



**Wearing method**

1. Hold the mask with your fingertips at the position of the nose clip to allow the headband to hang freely.
2. Put the mask around your chin with the nose clip facing upwards and wear the lower headband on the neck below the ears.
3. Put the upper headgear on the top of the head.
4. Use the index fingers of both hands to move from the middle of the nose clip to both sides and press down the nose clip until it is close to the bridge of the nose. One-handed operation is not recommended.
5. Before entering the work area, you must check the tightness of the mask and face, the inspection method is as follows:
  - a) Cover the mask with both hands, taking care not to affect the position of the mask on the face.
  - b) Take a deep breath. If you feel a leak near the bridge of the nose, adjust the nose clip again according to step 4;
  - c) If the leak is on the edge of the mask, the headgear should be readjusted.

Warning! If the mask and face cannot be in close contact, do not enter the work area. Please contact your supervisor.

**Removal method**

Referring to step 2 of the wearing method, hold the protective mask with one hand to maintain the wearing position, and use the other hand to pull down the headband and pull it over the top of the head. Continue to hold the mask with your hand, then pull the headband over the top of your head and remove the mask.

**LOT**  
3 years

生产日期 2020/08/22  
00098521

**Shandong Daddy's Choice Health Science and Technology Co., Ltd**  
Address: Tiandingfeng road Garden street Economic Development Zone  
Linyi County Dezhou City Shandong Province 251500 CN  
Tel: 0534-8271567, 0534-8271568;  
Website: www.daddychoice.com.cn  
Email: sales@daddychoice.com

MADE IN CHINA

6 973601 650148

**Restrictions on use**

1. This mask does not generate oxygen and cannot be used in environments where the oxygen content is below 19.5%.
2. It cannot be used in an environment that momentarily endangers life and health.
3. It cannot be used in an environment where the pollution concentration or content exceeds the maximum concentration prescribed by the government or the allowable exposure concentration value is 10 times.
4. Cannot be used in environments where the concentration of oily particulate matter or organic vapor exceeds occupational limits.
5. Please do not change, wash, abuse or misuse this protective mask.
6. Do not use beards or other facial hair or conditions that impede a good seal between the face and the sealing surface of the protective mask.
7. This mask is designed for occupational protective equipment, and the user should be an adult who has received training in proper use methods and understands the restrictions on use. This mask is not designed for children.

**Period of Validity:**3 years  
**Production Date/Batch Number:**Showing on the Packaging

**Precautions**

1. This product is only used for breathing protection against certain particulate matter. Misuse of protective masks will reduce its effectiveness and may cause disease or permanent damage to health or even death.
2. Before use, you should receive training on the correct method of use and follow the relevant safety and health standards.
3. Please carefully check whether all parts of the protective mask are intact before use. If damage occurs, the mask should be discarded or replaced.
4. This product is a disposable protective mask. When the mask is damaged during use or the breathing resistance is too high, be sure to replace the mask.
5. Use within the limits of applicable government regulations.
6. Leave the work area immediately if:
  - a) Feeling difficult to breathe;
  - b) Feeling sick and other discomforts.

**[Storage conditions]**

This product should be stored in a well-ventilated, dark and dry environment. Keep away from fire, pollutants and possible pollution.  
Storage temperature range: -20°C to 38°C; storage humidity: <80% relative humidity. When transporting this product use original packaging provided.

-20 °C      38 °C      <80% RH      See information supplied by the manufacturer      Do not re-use

## Masques Chirurgicaux Purism Type IIR



EXTERIEUR



INTERIEUR

MARQUE

PURISM

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

≥ 99%



## SPÉCIFICATIONS

Masque 3 couches :

- Première couche : tissu non-tissé étanche (nouveau tissu non-tissé) : inhibe et isole efficacement les particules et les gaz nocifs
- Seconde couche : couche filtrante haute densité (tissu non-tissé soufflé)
- Troisième couche : couche en contact direct avec la peau, en nouveau tissu non-tissé, résistant à l'humidité, permettant une respiration aisée, non toxique, non stimulant, doux et respectueux de la peau

Composition :

Tissu non tissé filé-lié, tissu non tissé soufflé par fusion, boucles d'oreille et barre de pont nasal

Temps de port recommandé :

4-8 heures, à changer entre deux actes médicaux. Après tout contact avec le masque usagé, veiller à se désinfecter les mains.

---

## APPLICATION

pour le personnel médical pendant les opérations. Il recouvre la bouche, le nez et la mâchoire de l'utilisateur, fournissant une barrière physique pour empêcher le passage direct d'agents pathogènes, de micro-organismes, de fluides corporels et de particules. Ne pas utiliser dans un environnement traumatique.

---

## CONFORMITÉ

Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE  
Norme EN 14683 Type IIR.

## CONDITIONNEMENT

10 pcs / sachet, 5 sachets / boîte., 48 btes / carton, 2400 pièces / carton,  
Dimensions du carton : 47,5 × 41,5 × 56 cm – 11,7 kg

## STOCKAGE

à stocker dans un endroit gazeux sec, propre, ventilé et non corrosif, loin de sources d'ignition ou de matériaux combustibles.

## DURÉE MAXIMUM DE STOCKAGE

3 ans





## SPÉCIFICATIONS

- Usage :** Intérieur/Extérieur
- Type :** Haute
- Activité :** Construction / Industrie propre / Industrie électronique, ESD
- Tige :** Microfibre ON MICRO TD® hydrofuge, montage Richelieu sans coutures latérales
- Doublure :** AIR SYSTEM® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet «chausson»
- Languette :** Soufflet étanche en microfibre ON STEAM®, doublé AIR SYSTEM® et matelassé mousse 10 mm
- Protège malléoles :** Microfibre ON STEAM® doublé AIR SYSTEM® et matelassé mousse 10 mm
- Fermeture :** Oeillets et lacets polyester ronds coloris noir
- Embout :** Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®
- Plaque antiperforation :** Composite FLEX SYSTEM®, amagnétique et athermique
- Première de propreté :** Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactéries FRECH TECH®
- Semelle :** PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
- Cramponnage :** Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambure, norme SRC
- Poids (Kg/pair) :** 1.200
- Couleurs :** Tige noire et semelle gris foncé/noir
- Pointures :** 35-49
- Normes :** EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191
- Certificat de conformité CE n° :** 0075/020/161/08/17/1266
- Spécificités :** Microfibre résistante aux acides et aux projections de soudure (UNE EN ISO 20349/2011)
- Spécificités 2 :** Liseré rétro-réfléchissant au talon
- Spécificités 3 :** Large choix de pointures : du 35 au 49 !



#### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

 Embout léger composite 200 joules

 Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)

 Décharge d'électricité  
Normes EN 61340-5-1

**CORDURA**

**on steam**

Doublure **ARTICO**

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

-  Propriétés antistatiques (A)
-  Absorption d'énergie au talon (E)
-  Résistance à l'abrasion
-  Semelle à crampons
-  Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
-  Isolation de la semelle contre le froid (CI)
-  Embout extra large 200 joules
-  Doublure hyper respirante
-  Résistance à la perforation 1100 N (P)



## SPÉCIFICATIONS

**Usage :** Intérieur/Extérieur

**Type :** Basse

**Activité :** Construction / Magasinage, logistique, transport / Industrie électronique, ESD

**Tige :** Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile CORDURA®

**Doublure :** ARTICO® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet «chausson»

**Languette :** Soufflet étanche en microfibre ON STEAM®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm

**Protège malléoles :**

**Fermeture :** Perforations et lacets ronds en polyester avec système «Quick lock»

**Embout :** Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®

**Plaque antiperforation :** Composite FLEX SYSTEM®, amagnétique et athermique

**Première de propreté :** Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®

**Semelle :** PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI

**Cramponnage :** Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambure, norme SRC

**Poids (Kg/pair) :** 1.200

**Couleurs :** Tige noire et semelle gris foncé/noir

**Pointures :** 35-48

**Normes :** EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1 / DGUV 112-191

**Certificat de conformité CE n° :** 0075/020/161/08/17/1266 - EXT 09/09/17

**Spécificités :** Système de fermeture rapide «Quick lock»

**Spécificités 2:** Liseré rétro-réfléchissant au talon



#### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

-  Embout léger composite 200 joules
-  Sans partie métallique, amagnétique
-  Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)

**CORDURA**



Double III  
**ARTICO**

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

-  Propriétés antistatiques (A)
-  Absorption d'énergie au talon (E)
-  Résistance à l'abrasion
-  Semelle à crampons
-  Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
-  Isolation de la semelle contre le froid (CI)
-  Embout extra large 200 joules
-  Doublure hyper respirante
-  Résistance à la perforation 1100 N (P)



## SPÉCIFICATIONS

- Usage :** Intérieur/extérieur
- Type :** Haute
- Activité :** Construction / Stockage, logistique, transport / Industrie électronique, ESD
- Tige :** Cuir souple hydrofuge et toile CORDURA®
- Doublure :** ARTICO® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet «chausson»
- Langnette :** Soufflet étanche en microfibre ON STEAM®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
- Protection malléoles :** Toile CORDURA®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
- Fermeture :** Passe-lacets acier et lacets ronds polyester coloris noir
- Embout :** Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®
- Plaque antiperforation :** Composite FLEX SYSTEM®, anti-magnetic et isolation thermique
- Première de propreté :** Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®
- Semelle :** PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
- Cramponnage :** Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambre, norme SRC
- Poids (Kg/pair) :** 1.200
- Couleurs :** Tige noire et semelle gris foncé/noir
- Pointures :** 35-48
- Normes :** EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1 / DGUV 112-191
- Certificat de conformité CE n° :** 0075/020/161/08/17/1266 - EXT 08/09/17
- Spécificités :** Fermeture rapide système «Quick lock»
- Spécificités 2 :** Passepoil réfléchissant sur la partie talon



#### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

-  100% composite (Air System + Light System + Flex System)
-  Sans partie métallique, amagnétique
-  Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)
-  Décharge d'électricité Normes EN 61340-5-1

**CORDURA**



Doublure **ARTICO**

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

-  Propriétés antistatiques (A)
-  Absorption d'énergie au talon (E) Résistance à l'abrasion
-  Semelle à crampons
-  Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
-  Isolation de la semelle contre le froid (CI)
-  Embout extra large 200 joules
-  Doublure hyper respirante
-  Résistance à la perforation 1100 N (P)

## NORA MULTIRALF WHITE



### SPÉCIFICATIONS

- Semelle :** intercalaire en matériel expansé : isolation du froid et amortisseur de chocs
- Embout :** acier
- Pointures :** 36-49/50

- ① Embouts en acier
- ② Intercalaire en matériel expansé
- ③ Semelle anti-perforation
- ④ Semelle optimisée
- ⑤ Système de mesure Mondpoint®
- ⑥ Qualité Gommaforte®



## MTS NORA MULTIRAF BLANCHE



### SPECIFICATIONS

- Intercalaire en matériel expansé : isolation du froid et amortisseur de chocs
- Pointure : 36-49/50
- Embout acier
- Semelle anti-perforation
- Semelle optimisée
- Système de mesure Mondopoint®
- Qualité Gommaforte®

### NORMES

- EN345 S4

## NORAMAX FOOD - BLANCHE



### SPECIFICATIONS

- Tige : polyuréthane – nettoyage facile
- Doublure : doublure antibactérienne
- Première de propreté : semelle mousse confort coussin Ortholite® Pointures : 35-48
- Semelle : semelle extérieure facile à nettoyer, anti-saleté – coefficient de glisse : SRC
- Plaque antiperforation : acier
- Embout : métal
- Pointures : 36-49
- Hauteur : 33 cm (référence : pointure 42)

### NORMES

- EN ISO 20345 :2011 S4 CI SRC

## SAFRON - BLANCHE



### SPECIFICATIONS

- EN345 Gommaforte®
- Mélange de caoutchouc et de matières thermoplastiques
- Haute résistance à l'usure
- Embout acier 200 joules
- Pointures : 36-47

### NORMES

- EN ISO 20345 :2011 – S4



#### SPECIFICATIONS

- Usage :** Extérieur
- Type :** Haute
- Activité :** Construction / Industrie électronique, ESD
- Tige :** Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile CORDURA®
- Doublure :** ARTICO® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet «chausson»
- Langue :** Soufflet étanche en microfibre ON STEAM®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
- Protège malléoles :** Toile CORDURA®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
- Fermeture :** Passe-lacets acier et lacets ronds polyester coloris noir
- Embout :** Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®
- Plaque antiperforation :** Acier inox
- Première de propreté :** Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®
- Semelle :** PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
- Cramponnage :** Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambure, norme SRC
- Poids (Kg/pair) :** 1.200
- Couleurs :** Tige noire et semelle gris foncé/noir
- Pointures :** 35-48
- Normes :** EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1 / DGUV 112-191
- Certificat de conformité CE n° :** 0075/020/161/08/17/1266 - EXT 14/09/17
- Spécificités :** Renfort d'embout en matériau spécifique résistant à l'abrasion piqûre sécurisée, étanche)
- Spécificités 2 :** Modèle spécialement étudié pour la Construction et BTP



#### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

 Embout léger composite 200 joules

 Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)

 Décharge d'électricité  
Normes EN 61340-5-1

**CORDURA**

 ON steam

Double III  
**ARTICO**

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

-  Propriétés antistatiques (A)
-  Absorption d'énergie au talon (E)
-  Résistance à l'abrasion
-  Semelle à crampons
-  Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
-  Isolation de la semelle contre le froid (CI)
-  Embout extra large 200 joules
-  AIR SYSTEM  
Doublure hyper respirante
-  Résistance à la perforation 1100 N (P)



#### SPECIFICATIONS

- Usage :** Intérieur
- Type :** Basse
- Activité :** Agro-alimentaire, restauration, médical / Industrie chimique
- Tige :** Matériau Dry-Tek® épaisseur 2.2 mm résistant aux acides, lavable et respirant
- Doublure :** Cambrelle+ Amicor® traitement « Refreshing » avec microcapsules parfumées
- Languette :** Matériau Dry-Tek®
- Protège malléoles :**
  - Fermeture :** Élastique sur le cou de pied
  - Embout :** Composite 200 joules Light System®
- Plaque antiperforation :**
  - Première de propreté :** Mousse avec traitement antibactérien et antimicrobien
  - Semelle :** PU 2D, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique et HI-Cl
- Cramponnage :** Spécial antiglisse sur sols lisses et gras, norme SRC
- Poids (Kg/pair) :** 0.800
- Couleurs :** Tige blanche et semelle bicolore blanc/gris clair
- Pointures :** 35-49
- Normes :** EN ISO 20345:2011 SRC
- Certificat de conformité CE n° :** 0075/020/161/04/13/0269
- Spécificités :** Tige sans coutures latérales, évite la pénétration d'eau
- Spécificités 2 :** Matériau Dry-Tek® résistant à 12 acides et fluides corrosifs (norme EN 13832-2)
- Spécificités 3 :** Lavable jusqu'à 60°



#### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

-  Embout léger composite 200 joules
-  Sans partie métallique, amagnétique
-  Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)

**Cambrelle+**  
with  
**Amicor\***

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

-  Propriétés antistatiques (A)
-  Absorption d'énergie au talon (E)
-  Résistance à l'abrasion
-  Semelle à crampons
-  Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)
-  Isolation de la semelle contre le froid (CI)
-  Embout extra large 200 joules
-  Doublure hyper respirante
-  Résistance à la perforation 1100 N (P)



**CONTIPHARMA**

a member of Bedelco group

**PROTECT**

## MOLIERE CORDES BLANCHE



### SPECIFICATIONS

Tige : cuir enduit

Doublure : Cambrelle®

Embout : Mousse latex

Première de propreté : PU 2D

Pointures : 35-48

### NORMES

· EN ISO 20345 :2011 – S2



#### **SPECIFICATIONS**

- Botte à cheville classique
- Dessus en cuir noir imprimé
- Collet rembourré à la cheville en matière synthétique sur mousse de 10 mm
- Languette à soufflet imperméable, rembourrée et doublée en PU synthétique sur mousse de 10 mm.
- Doublure en «Air System»® sur mousse, couleur grise
- Passepoils réfléchissants sur le comptoir extérieur
- Fermeture par lacets à travers les triangles
- Lacets en polyamide/polyester noir/beige
- Semelle intérieure complète en mousse de latex, antistatique et antibactérienne.
- Semelle antistatique en polyuréthane double densité
- Semelle extérieure à crampons à usages multiples
- Facteur antidérapant : 0,27
- Absorption des chocs au niveau du talon
- Embout en acier résistant à 200 joules
- Semelle intercalaire anti-perforation en acier
- Poids approximatif par paire : 1,2 kg (paire)
- Couleurs : tige noire et semelle noire
- Tailles : de 35 à 48



#### APPLICATIONS

- Multi-usages

#### LES NORMES

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011- SRC - Chaussures de sécurité.
- Testé par le C.T.C. (Centre Technique du Cuir)
- P.P.E. catégorie 2 (risques intermédiaires)
- Certificat de conformité : CE N° : 0075/020/161/05/13/0428 - EXT 05/05/13

## RAVEN S2 SRC MOCASSIN



### SPÉCIFICATIONS

Mocassin de sécurité avec insert. Semelle en PU antistatique à une densité antidérapante résistante aux huiles et usure mécanique, absorption de l'énergie sous le talon. Tige en microfibre résistant, doublure perméable et caractéristiques antibactériens.

**Antiperforation:**

**Tige :** Micro fibre

**Embout :** Métal

**Semelle :** Polyuréthane à densité unique

**Doublure :** Maille polyester

**Pointure :** 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

**Teinte :** 80 - blanc

CARACTÉRISTIQUES



NORMES

EN ISO 20345:2011 / S2 SRC



### SPÉCIFICATIONS

Bouchons d'oreilles jetables en mousse PU très souple, design ergonomique pour une insertion plus facile dans le conduit auditif et une adhésion parfaite à ses parois pour un grand confort d'utilisation. EN 352-2.

### CARACTÉRISTIQUES

- Système d'attachement Earplugs.
- Système de protection Passif.
- Jetable.

### NORMES

EN 352-2:2002.

Protect yourself  
Protect lives



**B** **CONTIPHARMA**  
a member of Bedelco group srl **PROTECT**

Rue de l'Environnement 22  
4100 Seraing  
Belgium

Mobile : +32 (0)4 330 18 60  
Email : [info@bedelco.com](mailto:info@bedelco.com)  
Web : [www.contipharma-protect.com](http://www.contipharma-protect.com)